




### PANIER EN FIL ACIER

En acier inox, AISI 304, poli électrolytiquement.

Modèles et dimensions ajustables a les autoclaves Selecta. (voir page, 53)


Code	Code
<b>1004771</b> de 220 Ø x 140 mm haut.	<b>1000496</b> de 365 Ø x 265 mm haut.
<b>1004772</b> de 220 Ø x 240 mm haut.	<b>1000780</b> de 435 Ø x 205 mm haut.
<b>1000495</b> de 265 Ø x 185 mm haut.	

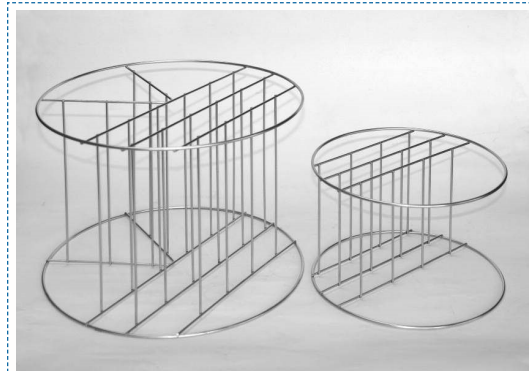

### ACCESSOIRES

Chassis en fil d'acier inox, AISI 304, poli électrolytiquement

Code		Pour panier Code
<b>1001217</b>	Chassis 4 compartiments	1000495
<b>1001218</b>	Chassis 6 compartiments	1000496
<b>1001222</b>	Chassis 7 compartiments	1000780

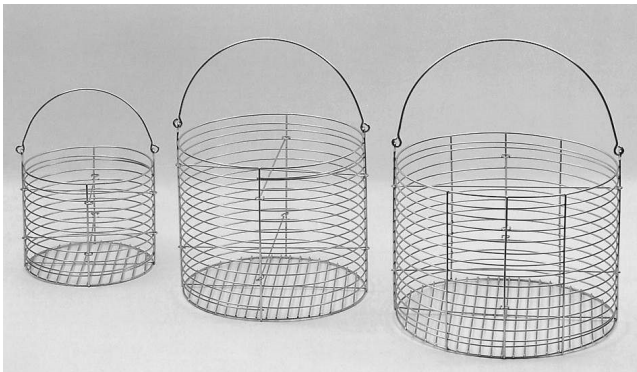

### PANIER EN FIL

En acier inox, AISI 304, poli électrolytiquement.

Code	
<b>1025115</b>	de 150 Ø x 120 mm de haut.
<b>1025121</b>	de 210 Ø x 180 mm de haut.
<b>1025124</b>	de 240 Ø x 180 mm de haut.

Avec croisillons.

Code
<b>1125115</b>
<b>1125121</b>
<b>1125124</b>



### TAMBOURS DE STÉRILISATION

En acier inox, AISI 304. Modèles ajustables a les autoclaves Selecta. (voir page, 53.)

Code	Ø cm	Haut, cm
<b>1002418</b>	25	18
<b>1002419</b>	35	27
<b>1002420</b>	28	18

**Ne s'adapte pas a les autoclaves Selecta.**



### BOÎTES À STÉRILISER LES PIPETTES

En acier inox, AISI 304.

Code	Haut, mm	utile Ø utile mm
<b>1000829</b>	400	72
<b>1001126</b>	400	130

### BOÎTES À STÉRILISER LES BOÎTES DE PÉTRI

En acier inox, AISI 304. Avec panier-portfolio de Ø jusqu'à 120 mm.

Code	Haut, mm	Ø utile mm	Capacité plaques
<b>1001127</b>	260	130	10
<b>1001128</b>	400	130	18



### PANIER POUR BOÎTES DE PÉTRI

En acier inox AISI 304, poli électrolytiquement. Pour 10 boîtes de 80 à 100 mm Ø. Ø.

Code **1000259**



### PANIER PORTE-PIPETTES

En acier inox, AISI 304, poli électrolytiquement. De 90 Ø x 250 mm de haut.

Code **1000251**



### BOÎTES À STÉRILISER LES PIPETTES

En acier inox, AISI 304. Couvercle intérieur et base recouverts de silicone pour protéger les pipettes.

Code	Haut, mm	utile mm	Ø utile mm
<b>1001597</b>	290	65	
<b>1001598</b>	340	65	